**Description of this Thermometer**

EN

Battery Replacement

When the «▼» symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover (3) from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Technical Specifications

Type: Maximum thermometer
Measurement range: 32.0 °C to 42.9 °C
 Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
 Temp. > 42.9 °C: display «H» for high (too high)

Measurement accuracy: ± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C
 ± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C

Operating conditions: 10 - 40 °C; 15-95% relative maximum humidity

Storage conditions: -25 - +60 °C; 15-95% relative maximum humidity

Battery: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Battery lifetime: approx. 2700 measurements (using a new battery)

IP Class: IP22

Reference to standards: EN 12470-3, clinical thermometers;
 IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
 IEC 60601-1-11

Expected service life: 5 years or 10000 measurements

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.

Important Safety Instructions

• Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read the document thoroughly before using the device and keep for future reference.

• This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.

• Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.

• We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.

• The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!

Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».

• Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.

• Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio transmitters. Keep a minimum distance of 30 cm from such devices when using this device.

• Protect the device from impact and damage.

• Avoid heating the thermometer probe more than 45°!

• Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!

• Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.

• We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact Microlife Service to arrange the test.

WARNING: The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only. Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Partie appliquée type BF**Tuning on the Thermometer**

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button (1), a short beep signals thermometer ON. A display test is performed. All segments should be displayed.

The last measurement reading will be shown on the display (2) automatically for 2 seconds with the «M» icon.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a «H» icon «» appear at the display field (2). The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Before use, keep this thermometer out of any physical contact, for at least 2 hours. This utilizes the antimicrobial copper properties, as described in chapter «Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing Healthcare associated Infections». European Infectious Disease, Volume 5, Issue 2, Autumn 2011.

Instructions Importantes de seguridad

• Siga las instrucciones de uso. Este documento proporciona información importante de operación y seguridad del producto con respecto a este dispositivo. Lea atentamente este documento antes de usar el dispositivo y conservelo para futuras consultas.

• Este dispositivo solo se debe utilizar para medir la temperatura del cuerpo humano. No intentar tomar temperaturas en otros sitios, como en el oído, ya que puede dar lugar a lecturas falsas y provocar lesiones.

• No utilice el dispositivo si cree que puede estar roto o detecta alguna anomalía.

• Recomendamos limpiar este dispositivo de acuerdo con las instrucciones de limpieza antes del primer uso para la higiene personal.

• Los siguientes artículos están excluidos de la garantía:

• Daños causados por la aplicación incorrecta o el incumplimiento de las instrucciones de uso.

• Daño causado por accidente o mal uso.

• Material de embalaje / almacenamiento e instrucciones de uso.

• Comprobaciones periódicas y mantenimiento (calibración).

• Accesorios y piezas de desgaste. Batería.

En caso de que se requiera un servicio de garantía, comuníquese con el distribuidor donde adquirió el producto o con su servicio local Microlife. Puede ponerse en contacto con su servicio local Microlife a través de nuestro sitio web: www.microlife.com/support.

• No utilice el dispositivo cerca de fuentes de calor o frío.

• Evite someter el instrumento a una temperatura ambiente superior a 60 °C, ¡El instrumento NUNCA debe ser hervido!

• Use solo los desinfectantes comerciales enumerados en la sección «Cleaning and Disinfecting» para limpiar el dispositivo y evitar daños en el dispositivo.

• Recomendamos revisar la precisión de este instrumento cada dos años o después de un impacto mecánico (p.ej., si se ha caído). Por favor, contacte al servicio técnico Microlife para concertar la revisión.

• Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

• Pieza aplicada tipo BF

Puesta en marcha del termómetro

Para encender el termómetro, pulse el botón ON/OFF (1); un breve pitido o señal de bocina indica que el termómetro está encendido. Se realiza una prueba de pantalla. Todos los iconos deben aparecer en el pantalla.

• En la mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C

No eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor (4) must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

• Approx. measuring time: 10 seconds!

Carefully insert the measuring sensor (4) of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and/or a lubricant is recommended. If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

• Approx. measuring time: 10 seconds!

Cleaning and Disinfecting

For disinfection use environment, use a 70% isopropyl alcohol swab, or a cotton tissue moistened with 70% isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe (note: consider the application and safety instruction of the disinfectant manufacturer). Always start wiping from the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer probe (see number (5) in the drawing) should be immersed in 70% isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use. Avoid immersing or wiping the display to protect it from fading.

The thermometer is not intended for professional use.

• En la armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C

Carefully insert the measuring sensor (4) of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and/or a lubricant is recommended.

• Approx. measuring time: 10 seconds!

Cleaning and Disinfecting

For disinfection use environment, use a 70% isopropyl alcohol swab, or a cotton tissue moistened with 70% isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe (note: consider the application and safety instruction of the disinfectant manufacturer).

Always start wiping from the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer probe (see number (5) in the drawing) should be immersed in 70% isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use. Avoid immersing or wiping the display to protect it from fading.

The thermometer is not intended for professional use.

• En la boca (oral) / 35.5 - 37.5 °C

Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor (4) must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

• Approx. measuring time: 10 seconds!

Carefully insert the measuring sensor (4) of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and/or a lubricant is recommended.

• Approx. measuring time: 10 seconds!

Importantes précautions d'emploi

• Respectez les instructions d'utilisation. Ce document fournit des informations importantes sur le fonctionnement et la sécurité de cet appareil. Veuillez lire cette période de garantie, à notre discretion, Microlife réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux. Le fait d'ouvrir ou de modifier l'appareil invalide la garantie.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé pour mesurer la température du corps humain avec une oreille, rectale ou axillaire. N'essayez pas de prendre des températures sur d'autres parties, comme dans l'oreille, cela peut entraîner de fausses lectures et des lésions.

• N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou si vous remarquez quelque chose d'inhabituel.

Descripción del termómetro

Para encender el termómetro, pulse el botón ON/OFF (1); un breve pitido o señal de bocina indica que el termómetro está encendido. Se realiza una prueba de pantalla. Todos los iconos deben aparecer en el pantalla.

• En la boca (oral) / 35.5 - 37.5 °C

No comer ni beber nada caliente ni fría 10 minutos antes de la medida. La boca debe permanecer cerrada hasta 2 minutos antes de comenzar una lectura.

Posicionar el termómetro en una de las dos bolsas debajo de la lengua, a la derecha o a la izquierda de la raíz de la lengua. El sensor de medida viene con una cubierta de silicona para conveniente el uso.

• Limpieza y desinfección (solo sonda de termómetro)

Este Termómetro Digital Médico Antimicrobico ofrece lecturas precisas en el rango de temperatura del cuerpo humano. Al mismo tiempo, reduce la flora microbial y minimiza la dispersión de microorganismos contagiosos, proporcionando una alta seguridad para el usuario.

*Efstathios A. Panos «The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing Healthcare-associated Infections», European Infectious Disease, Volume 5, Issue 2, Autumn 2011.

Propiedades antimicrobianas del cobre

Surfaces made or covered by special copper alloys, have strong antimicrobial properties against a wide variety of microorganisms*. Copper alloys enter the human body through the skin, contact with mucous membranes and bacteria. They kill microorganisms that come into contact with the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

These microorganisms are destroyed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

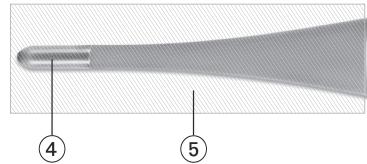
Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

Microorganisms that come into contact with the coated area are killed by the action of copper ions on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously kills the rest of the body.

**De thermometer aanzetten**

Om de thermometer aan te zetten drukt u de ON/OFF knop (1) in, een korte keer wordt aangegeven dat de thermometer ingeschakeld is. Een weer-gaveverdugt wordt uitgevoerd. Alle functiemogelijkheden worden weergegeven. De laatste meting zal automatisch worden getoond op het display (2) gedurende 2 seconden met het **L**-symbool.

Bij een kamertemperatuur van minder dan 32 °C verschijnt eerst het symbool **L** in het display, vervolgens knippert het symbool ***C** in het display (2). De thermometer is nu gereed voor gebruik.

Functietest

Raak het oppervlakken oppervlakte minstens 2 uur voor gebruik niet aan, zodat de antimicrobische koper eigenschappen hun werk kunnen doen zoals beschreven in het hoofdstuk **Antimicrobische koper eigenschappen**. Het gebruik van antimicrobisch koper is een aanvulling op en geen vervanging van de gebruikelijke ontsmettingsmaatregelen.

Gebruik van de thermometer

Raak de werkende thermometer niet elke keer automatisch getest wanneer hij wordt aangezet. Als er een defect wordt geconstateerd moet de thermometer niet meer worden gebruikt.

Substitutie da pilha

Quando o símbolo «▼» (triângulo invertido) for apresentado no mostrador a pilha está descarregada e necessita de ser substituída. Para substituir a pilha coloque a sinal + virado para cima. Certifique-se de que se trata de uma pilha do mesmo tipo. As pilhas podem ser adquiridas em qualquer loja de material elétrico.

Especificações técnicas

Tipo: Termômetro de máxima
Gama de medição: 32,0 °C a 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: visualizado o símbolo «L» correspondente à temperatura baixa (desmasiado baixa)
Temp. > 42,9 °C: é apresentado o símbolo «H» correspondente à temperatura elevada (desmasiado elevada)

Precisão da medição: ± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C
± 0,2 °C; 32,0 °C - 33,9 °C e 42,1 - 42,9 °C

Condições de funcionamento: 10 - 40 °C; 15-95 % humidade relativa máxima

Condições de acondicionamento: -25 - +60 °C; 15-95 % humidade relativa máxima
Pilha: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Duração da pilha: aprox. 2700 medições (usando uma pilha nova)
IP Class: IP22
Normas de referência: EN 12470-3, termômetros clínicos, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Duração expectável de utilização: 5 anos a 10000 medições

Este dispositivo é em conformidade com as exigências da Norma de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.

O fabricante reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas.

Garantia

Este dispositivo está abrangido por uma garantia de 5 anos a partir da data de compra. Durante este momento de garantia, ao seu critério, o representante da Microlife trocará o seu produto defetoso, sem qualquer custo.

A garantia não é válida se o dispositivo for aberto ou alterado. Os seguintes itens estão excluídos da garantia:

- Custos de transporte e risco de transporte.
- Danos causados por aplicação incorreta ou o não seguimento das instruções de utilização.
- Danos causados pelo vazamento das pilhas.
- Material e armazenamento do embalagem ou instrução de utilização.
- Verificações regulares e Manutenção (calibração).
- Acessórios e peças (pilhas).

Se for necessário o uso da garantia, por favor contacte o distribuidor da Marca Microlife. Pode contactar o seu serviço Microlife local através do nosso site: www.microlife.com/support

Compensação é limitada ao valor do produto. A garantia será limitada se o produto estiver completo e devolvido com a fatura original de compra. Troca dentro do período de garantia não prolonga ou renova o período de garantia. As reivindicações legais e direitos dos consumidores não são aplicados por esta garantia.

AVISO: O resultado da medição fornecido por este dispositivo não é um diagnóstico! Não é apenas no resultado da medição.

As pilhas e dispositivos eletrónicos têm de ser eliminados em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis, uma vez que não são considerados resíduos domésticos.

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo.

Peça aplicada tipo BF

Ligar o termômetro

Para ligar o termômetro, pressione o botão ON/OFF (1); um breve sinal sonoro indica que o termômetro está ligado (ON). É efetuado um teste ao visor. Deverá visualizar-se todos os ícones.

A última medição efetuada será indicada no visor (2) automaticamente durante 2 segundos com o ícone ***C**.

Em seguida, a um temperatura ambiente inferior a 32 °C, são apresentados os símbolos **L** e **H** a piscar no mostrador (2). O termômetro pode agora ser utilizado.

Teste de funcionamento

O funcionamento correto do termômetro é testado automaticamente sempre que o instrumento é ligado. Se for detectada qualquer anomalia (medição incorreta), o visor indicará a informação **ERR**, ficando impossibilitada a medição. Caso esta situação se verifique, é necessário substituir o termômetro.

Utilização do termômetro

Antes de utilizar, manter o termômetro fora de qualquer contato físico, por pelo menos 2 horas. Este utiliza as propriedades antimicrobianas do cobre, tal como descrito no capítulo **Propriedades do cobre antimicrobiano**. A utilização de cobre antimicrobiano é um suplemento e não um substituto para as práticas padrão de controle infecioso. Os utilizadores devem continuar a seguir todo o actual controlo de infecção e práticas de limpeza. Recomendamos a limpeza do termômetro como descrito no capítulo **Cleaning and Disinfecting**.

Escolha o método preferido de medição. Quando medir a temperatura, a temperatura corrente é continuamente visível e o símbolo ***C** deixa de piscar, significando que a diferença de temperatura é menor de 0,1 °C em 16 segundos.

Para prolongar a duração da pilha, desligue o termômetro pressionando breves instantes o botão ON/OFF (1). Caso contrário, o termômetro desliga-se automaticamente depois 10 minutos.

Memória dos valores medida

Sem manter o botão ON/OFF (1) pressionado durante mais de 3 segundos, quando ligar o termômetro, será apresentada a temperatura máxima memorizada automaticamente durante a última medição. Simultaneamente, será apresentado o símbolo **M**, correspondente à memória, o valor da temperatura apaga-se e o termômetro fica pronto para efectuar uma nova medição.

Métodos de medição / Temperatura corporal normal

Debaixo do braço (axilar) | 34,7 - 37,3 °C

Higienize a axila com uma toalha seca. Coloque o sensor de medição (4) sob o braço no centro da axila, de modo a que a ponta do dispositivo toque na pele, e posição o braço perto do corpo. Isto deve ser feito de forma a evitar a leitura. Porque a medição na axila leva mais tempo para atingir uma temperatura estabilizada, deve aguardar pelo menos 5 minutos, independentemente do sinal sonoro.

Não bocas (oral) | 35,5 - 37,5 °C

Não ingira ou beba alguma coisa ou frio 10 minutos antes da medição. A boca deve manter-se fechada 2 minutos depois do começo da leitura.

Coloque o termômetro num dos lados sob a língua, à esquerda ou à direita do freio da língua. O sensor de medição (4) tem de estar em contacto com a mucosa. Feche a boca e respire normalmente pelo nariz para evitar que a medição seja influenciada pela inspiração/expiração.

Tempo de medição aproximado: 10 segundos!


No ânus (rectal) | 36,6 - 38,0 °C

Introduza cuidadosamente o sensor de medição (4) do termômetro 2 a 3 cm dentro do ânus.

Recomenda-se a utilização de uma tampa de sonda (descartável) e a utilização de um lubrificante.

Caso não tenha certeza de como realizar este método de medição, consulte um profissional de saúde para obter ajuda.

Tempo de medição: 10 segundos!

**Descrição do termômetro**

- Botão ON/OFF
- Visor
- Tampa do compartimento da pilha
- Sensor de medição / Porta de medição
- Zona de Desinfecção e limpeza (Apêndice sonda do termômetro)

Este Termômetro Clínico Digital Antimicrobiano proporciona alta precisão das leituras da temperatura do corpo humano. Ao mesmo tempo, reduz a flora microbiana e minimiza a dispersão de microrganismos contagiosos, proporcionando uma maior segurança para o utilizador.

Propriedades do cobre antimicrobiano

Propriedades fetais ou revestidas de ligas de cobre, têm fortes propriedades antimicrobianas contra uma vasta variedade de microrganismos. Esta atividade antimicrobiana reduz a flora sujidade da sonda e superfície do termômetro (meting ontaanwekking), wordt dit aangegeven door **ERR** in het display (2) gedurende 2 seconden met het **M**-symbool.

Bij een kamertemperatuur van minder dan 32 °C verschijnt eerst het symbool **L** in het display, vervolgens knippert het symbool ***C** in het display (2). De thermometer is nu gereed voor gebruik.

Gebruik van de thermometer

Raak het oppervlakken oppervlakte minstens 2 uur voor gebruik niet aan, zodat de antimicrobische koper eigenschappen hun werk kunnen doen zoals beschreven in het hoofdstuk **Antimicrobische koper eigenschappen**.

Gebruik van de thermometer

Para desinfecção do dispositivo em casa, utilize um coneteiro com álcool isopropílico 70% ou com um algodão húmedo com 70% álcool isopropílico para limpar sujidade da sonda e superfície do termômetro (meting ontaanwekking), wordt dit aangegeven door **ERR** in het display (2) gedurende 2 seconden met het **M**-symbool.

Bij een kamertemperatuur van minder dan 32 °C verschijnt eerst het symbool **L** in het display, vervolgens knippert het symbool ***C** in het display (2). De thermometer is nu gereed voor gebruik.

Functietest

De working of the thermometer wordt elke keer automatisch getest wanneer hij wordt aangezet. Als er een defect wordt geconstateerd moet de thermometer niet meer worden gebruikt.

Substituição da pilha

Quando o símbolo **▼** (triângulo invertido) for apresentado no mostrador a pilha está descarregada e necessita de ser substituída. Para substituir a pilha retire a tampa do compartimento da pilha (3) e substitua-a por uma nova pilha do mesmo tipo. As pilhas podem ser adquiridas em qualquer loja de material elétrico.

Especificações técnicas

Tipo: Termômetro de máxima

Gama de medição: 32,0 °C a 42,9 °C

Temp. < 32,0 °C: visualizado o símbolo «L» correspondente à temperatura baixa (desmasiado baixa)

Temp. > 42,9 °C: é apresentado o símbolo «H» correspondente à temperatura elevada (desmasiado elevada)

Precisão da medição: ± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C

± 0,2 °C; 32,0 °C - 33,9 °C e 42,1 - 42,9 °C

Condições de funcionamento: 10 - 40 °C; 15-95 % humidade relativa máxima

Condições de acondicionamento: -25 - +60 °C; 15-95 % humidade relativa máxima

Pilha: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Duração da pilha: aprox. 2700 medições (usando uma pilha nova)

IP Class: IP22

Normas de referência: EN 12470-3, termômetros clínicos, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Duração expectável de utilização: 5 anos a 10000 medições

Este dispositivo é em conformidade com as exigências da Norma de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.

O fabricante reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas.

Garantia

Este dispositivo está abrangido por uma garantia de 5 anos a partir da data de compra. Durante este momento de garantia, ao seu critério, o representante da Microlife trocará o seu produto defetoso, sem qualquer custo.

A garantia não é válida se o dispositivo for aberto ou alterado.

Os seguintes itens estão excluídos da garantia:

Custos de transporte e risco de transporte.

Danos causados por aplicação incorreta ou o não seguimento das instruções de utilização.

Danos causados pelo vazamento das pilhas.

Material e armazenamento do embalagem ou instrução de utilização.

Verificações regulares e Manutenção (calibração).

Acessórios e peças (pilhas).

Se for necessário o uso da garantia, por favor contacte o distribuidor da Marca Microlife. Pode contactar o seu serviço Microlife local através do nosso site: www.microlife.com/support

Compensação é limitada ao valor do produto. A garantia será limitada se o produto estiver completo e devolvido com a fatura original de compra. Troca dentro do período de garantia não prolonga ou renova o período de garantia. As reivindicações legais e direitos dos consumidores não são aplicados por esta garantia.

Meetmethoden / Normale lichaamstemperatuur

Onder de oksel (auxiliar) | 34,7 - 37,3 °C

Depois de oksel af met droge handdoek. Plaats de meetensor (4) onder de arm in het midden van de oksel, zodat de punt van de huid raakt en plaats de armen naast het lichaam.

Totdat de thermometer bereid is om de temperatuur te meten, moet de oksel goed zijn voorbereid.

Dit moet gedurende 10 seconden gedurende 2 seconden met het **M**-symbool.

Wanneer de thermometer bereid is om de temperatuur te meten, moet de oksel goed zijn voorbereid.

De thermometer is nu gereed voor gebruik.

Reinigen en desinfecteren

Onder de oksel (auxiliar) | 34,7 - 37,3 °C

Wanneer de thermometer bereid is om de temperatuur te meten, moet de oksel goed zijn voorbereid.

De thermometer is nu gereed voor gebruik.

Garantia

Este dispositivo está abrangido por uma garantia de 5 anos a partir da data de compra. Durante este momento de garantia, ao seu critério, o representante da Microlife trocará o seu produto defetoso, sem qualquer custo.

A garantia não é válida se o dispositivo for aberto ou alterado.

Os seguintes itens estão excluídos da garantia:

Custos de transporte e risco de transporte.

Danos causados por aplicação incorreta ou o não seguimento das instruções de utilização.

Danos causados pelo vazamento das pilhas.

Material e armazenamento do embalagem ou instrução de utilização.

Verificações regulares e Manutenção (calibração).

Acessórios e peças (pilhas).

Se for necessário o uso da garantia, por favor contacte o distribuidor da Marca Microlife. Pode contactar o seu serviço Microlife local através do nosso site: www.microlife.com/support

Compensação é limitada ao valor do produto. A garantia será limitada se o produto estiver completo e devolvido com a fatura original de compra. Troca dentro do período de garantia não prolonga ou renova o período de garantia. As reivindicações legais e direitos dos consumidores não são aplicados por esta garantia.

Meetsysteem / Klassieke thermometer

Onder de oksel (auxiliar) | 34,7 - 37,3 °C

Wanneer de thermometer bereid is om de temperatuur te meten, moet de oksel goed zijn voorbereid.

De thermometer is nu gereed voor gebruik.

Garantie

Este dispositivo está abrangido por uma garantia de 5 anos a partir da data de compra. Durante este momento de garantia, ao seu critério, o representante da Microlife trocará o seu produto defetoso, sem qualquer custo.

A garantia não é válida se o dispositivo for aberto ou alterado.

Os seguintes itens estão excluídos da garantia:

Custos de transporte e risco de transporte.

Danos causados por aplicação incorreta ou o não seguimento das instruções de utilização.

Danos causados pelo vazamento das pilhas.

Material e armazenamento do embalagem ou instrução de utilização.